Раздел 1. Клиническая биохимия

Наборы реагентов для биохимических автоматических анализаторов “СЕРИЯ САПФИР”	2
Нормальные значения гемограммы взрослых, получаемые на гематологических анализаторах	17
Наборы реагентов для биохимических исследований “СЕРИЯ 300”	18
Латекс - реагенты для экспресс - диагностики	42
Калибровочные растворы	42
Промывающие растворы для биохимических анализаторов	43
Прочее	43

Раздел 2. Гематология, цитохимия, микробиология.

Красители и наборы для гематологии	43
Красители и наборы для цитохимии	44
Наборы для контроля качества предстерилизационной очистки и обнаружения скрытой крови в биоматериале	46
Микробиология	46

Раздел 3. Оборудование и расходные материалы для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов

Контейнеры для первичного сбора отходов ЛПУ	47
Пакеты для сбора, хранения медицинских отходов	47
Пакеты с биоразлагаемой добавкой для сбора, хранения медицинских отходов	48

Раздел 4. Журналы для работы в ЛПУ

Журналы для работы в ЛПУ	51

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
С12.1.20	41993	**АЛТ кинетика IFCC**	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом.	1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, pH 7,5 при 37°С; L-аланин - 500 ммоль/л; ЛДГ>1200 МЕ/л. 2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
С 12.5.20	41994			
С12.5.50	41995			
С17.2.50	42045	**Альбумин BCG**	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом на основе реакции с бромкрезоловым зеленым.	1. Монореагент, pH 4,2; Цитрат натрия – 100 ммоль\л. Бромкрезоловый зеленый – 100 мкмоль\л. 2. Калибратор – 45 г\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
С17.5.50	42046			
С14.5.20	42314	**Альфа-Амилаза кинетика**	Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях кинетическим оптимизированным методом.	1. Good`s буфер, 50 ммоль/л, pH 6,0 $CaCl_2$ – 2 ммоль\л; NaCl – 100 ммоль\л. 2. Субстрат: G3ClpNPh – 5 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
С14.5.50	42315			
С13.1.20	41942	**АСТ кинетика, IFCC**	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом.	1. Good`s буфер, 80 ммоль/л, pH 7,8 при 37°С; L- аспартат - 240 ммоль/л; МДГ > 600 МЕ\л; ЛДГ > 1200 МЕ/л. 2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
С13.5.20	41949			
С13.5.50	41946			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049
(812) 727-2440

Наборы реагентов Серия «САПФИР» - специально разработаны для автоматических анализаторов «Сапфир», а также для выполнения исследований вручную и на полу-автоматах. Поставляемые в наборах реактивы имеют длительный срок годности: до 1 – 2 лет. При этом рабочий раствор можно приготовить в необходимом количестве, что позволяет использовать эти наборы в лабораториях различной мощности. Соотношение исходных реактивов при приготовлении рабочих реагентов одинаково для всех наборов (9:1)

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должно быть проведено в день забора образца, так как активность АЛТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 2 до 190 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5%	18 мл + 2 мл
		5 х 18 мл + 5 х 2 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл
Сыворотка крови. Использование липемических или гемолизированных образцов недопустимо. Образцы стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 15 до 60 г\л. Коэффициент вариации – 5%	2 х 50 мл
		5 х 50 мл
1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С не более 30 суток. 2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде. Довести pH образца до слабощелочного значения перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С не более 7 суток.	Линейность – от 16 до 1640 МЕ/л. Коэффициент вариации – 5%	5 х 18 мл + 5 х 2 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должнобыть проведено в день забора образца, так как активность АСТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 2 до 190 МЕ/л. Коэффициент вариации – не более 5%	18 мл + 2 мл
		5 х 18 мл + 5 х 2 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C62.5.20*	42326	**Белок PGR**	Набор реагентов для определения общего белка в ликворе и моче колориметрическим способом на основе реакции с пирогаллоловым красным. Колориметрический метод.	1. Монореагент, pH 2,5 (конечные концентрации в тесте): Сукцинат натрия – 50 ммоль\л; Молибдат натрия – 1,6 ммоль\л; Пирогаллоловый красный – 0,6 ммоль\л. 2. Калибратор: альбумин бычий сывороточный – 0,2 г\л. NaCl – 150 ммоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 24 месяцев.
C62.5.50*	42329			
C61.5.50	42377	**Белок общий**	Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови биуретовым методом.	1. Монореагент: NaOH – 100 ммоль\л; KJ – 15 ммоль\л; $KNaC_4H_4O_6$ – 21 ммоль\л; $CuSO_4$ – 6 ммоль\л. 2. Калибратор: альбумин бычий сывороточный – 60 г\л. NaCl – 150 ммоль\л. Все компоненты набора готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 24 месяцев.
C61.1.250	42383			
C61.3.250	42385			
C261.1.250	42433	**Билирубин общий**	Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке или плазме крови. Метод Маллой-Эвелина.	1. Сульфаниловая кислота – 8 ммоль\л. ДМСО – 7,0 моль\л 2. Нитрит натрия – 72 ммоль\л 3. Калибратор Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
C261.2.250	42434			
C262.1.250	42435	**Билирубин прямой**	Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме крови. Метод Маллой-Эвелина.	1. Сульфаниловая кислота – 8 ммоль\л. 2. Нитрит натрия –100 ммоль\л 3. Калибратор Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
C262.2.250	42436			
C11.1.10	42466	**ГГТФ кинетика**	Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом.	1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, pH 8,0; Глицилглицин - 150 ммоль/л; 2. Субстрат. pH 7,15 L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 6 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C11.5.10	42469			
C11.5.50	42991			

*** Внимание!**
Для данного метода приобретайте контрольный материал адаптированный для контроля качества химических методов исследования мочи, в список которых входит колориметрический метод на основе реакции с пирогаллоловым красным.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Моча утренняя порция. Не применять консервантов. В период сбора образца содержать его на льду. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение года при температуре -20º С. 2. Ликвор. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение 3 суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при температуре -20º С. Исследуемые образцы не должны содержать крови.	Линейность – от 0,1 до 3,0 г/л. Коэффициент вариации – не более 5%	5 х 20 мл
		5 х 50 мл
Сыворотка или плазма крови. Срок хранения исследуемых образцов при температуре 2-8º С не более 3 суток; при температуре -20º С не более 6 месяцев.	Линейность – от 14 до 100 г/л. Коэффициент вариации – не более 5%	5 х 50 мл
		250 мл
		3 х 250 мл
Сыворотка крови, гепаринизированная или ЭДТА-плазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить в темноте.	Линейность – от 2,0 до 340 мкмоль/л или от 4,0 до 680 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5%	250 мл + 10 мл
		2 х 250 мл + 2 х 10 мл
Сыворотка крови, гепаринизированная или ЭДТА-плазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить в темноте.	Линейность – от 2,0 до 250 мкмоль/л Коэффициент вариации – не более 5%	250 мл + 5 мл
		2 х 250 мл + 2 х 5 мл
Сыворотка крови. Образцы стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.	Линейность – от 6 до 230 МЕ/л Коэффициент вариации – не более 5%	9 мл + 1 мл
		5 х 9 мл + 5 х 1 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C42.1.50	42473	**Глюкоза UV - HK**	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо-глюкозо-6-фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом. “Гексокиназный” метод.	1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, pH 7,6; АТФ – 4 ммоль\л; $НАД^+$ - 3 ммоль\л; 2. Раствор ферментов: Гексокиназа > 1000 МЕ\л; Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа > 3000 МЕ\л; 3. Калибратор – 5,55 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
C42.5.50	42474			
C41.3.50	42491	**Глюкоза GOD - PAP**	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Глюкозооксидазный метод по Триндеру.	1. Буфер, pH 7,5: Na_2HPO_4 – 150 ммоль\л; Фенол – 11 ммоль\л; 4-ААП – 0,77 ммоль\л; 2. Раствор ферментов: Глюкозооксидаза – 15000 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л. 3. Калибратор – 5,55 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 24 месяцев.
C41.3.250	42493			
C10.1.20	42515	**Железо Nitro-PAPS**	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации.	1. Монореагент, pH 4,3: $C_2H_3O_2Na$ – 50 ммоль\л; Nitro-PAPS – 35 мкмоль\л; CH_5N_3 x HCl – 2,25 моль\л; 2. Калибратор – 30 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев. Нагревание монореагента до температуры свыше 25º С в течение короткого времени (от 3 до 5 суток) приводит к термическому разрушению Nitro-PAPS.
C10.1.50	42516			
C10.5.20	42517			
C10.5.50	42518			
C08.1.20	42560	**Калий**	Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации.	1. Монореагент: Тетрафенилборат натрия – 35 ммоль\л; Натрий едкий – 200 ммоль\л. 2. Калибратор – 5 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев. После вскрытия упаковки монореагент стабилен в течение 1 месяца при температуре 18-25º С.
C08.5.20	42561			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для предупреждения потерь. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3 суток при 2-8º С. 2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов при температуре 18-25º С. 3. Моча. Собирать в темную посуду на льду. Консерванты для суточной мочи – 5 мл ледяной уксусной кислоты или 5 г бензоата или фторида натрия. 4. Ликвор. Исследовать немедленно во избежание ложно низких результатов. Хранить при -20º С.	Линейность – от 1,0 до 38,9 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5%	50 мл + 0,5 мл
		5 х 50 мл + 5 х 0,5 мл
Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для предупреждения потерь. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3 суток при 2-8º С.	Линейность – от 0,55 до 22,2 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5%	3 х 50 мл + 3 х 1 мл
		3 х 250 мл + 3 х 5 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при температуре 18-25º С.	Линейность – 5-179 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5%	20 мл
		50 мл
		5 х 20 мл
		5 х 50 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить не более 8 часов при температуре 2-8º С.	Линейность – от 1 до 10 ммоль\л. Коэффициент вариации – не более 7%	20 мл
		5 х 20 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C071.1.50	42548	**Кальций Арсеназо III**	Набор реагентов для определения концентрации кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом с Арсеназо III.	1. Монореагент, pH 6,0: Натрий уксуснокислый – 100 ммоль\л; Арсеназо III - 250 мкмоль\л. 2. Калибратор – 2,5 ммоль\л Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
C071.5.50	42549			
C072.1.100	42533	**Кальций OCP**	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом с о-крезолфталеиновым-комплексоном.	1. Буфер, pH 10,7: Моноэтаноламин – 750 ммоль\л; 2. Хромоген: о-крезолфталеин-комплексон – 0,3 ммоль\л; 8-гидроксиквинолин – 10 ммоль\л. 3. Калибратор – 2,5 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
C072.1.200	42534			
C16.1.60	42410	**Креатинин ПК**	Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депротеинизации.	1. Пикриновая кислота – 35 ммоль\л; 2. Натрий едкий – 100 ммоль\л; 3. Калибратор – 177 мкмоль\л. Реагенты стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 18 месяцев.
C16.1.100	42411			
C16.1.200	42412			
C28.1.20	42750	**Креатинкиназа NAC кинетика**	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови энзиматическим кинетическим методом.	1. Буфер – имидазол – 100 ммоль\л, pH 6,7; N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л; НАДФ – 1,2 ммоль\л; Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л; Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л. 2. Субстрат – креатинфосфат – 30 ммоль\л. Реагенты стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C28.5.20	42751			
C281.1.20	43479	**Креатинкиназа MB кинетика**	Набор реагентов для определения активности MB-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови энзиматическим кинетическим иммунологическим методом.	1. Буфер – имидазол – 100 ммоль\л, pH 6,7; N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л; НАДФ – 1,2 ммоль\л; Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л; Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л. КК-ММ-антитела – 2000 МЕ\л. 2. Субстрат – креатинфосфат – 30 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C281.3.20	43480			
C281.3.20	43480			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови натощак. Кровь брать при минимальном пережатии вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА! 2. Моча суточная. Собирать в емкость, содержащую 10 мл 6 моль\л HCl, или подкислить после сбора до pH 3-4 для растворения солей кальция. Образец перед анализом развести бидистиллированной водой в соотношении 1:1.	Линейность – от 0,3 до 4,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	50 мл 5 х 50 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови натощак. Кровь брать при минимальном пережатии вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА!	Линейность – от 0,2 до 3,75 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	50 мл + 50 мл 100 мл + 100 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Липемическая и гемолизированная сыворотка или плазма крови для анализа не пригодна. Возможно хранение образцов при температуре 2-8º С в течение суток. 2. Моча суточная, разведенная непосредственно перед анализом дистиллированной водой в соотношении 1: 49. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 4 суток.	Линейность – в сыворотке\плазме от 5 до 885 мкмоль\л, в моче – от 0,25 до 44,2 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	30 мл + 30 мл 50 мл + 50 мл 100 мл + 100 мл
Сыворотка крови. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.	Линейность – от 5 до 1040 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	18 мл + 2 мл 5 х 18 мл + 5 х 2 мл
Сыворотка крови, гепаринизированная- или ЭДТА-плазма Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.	Линейность – от 2 до 1000 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	18 мл + 2 мл 3 х 18 мл + 3 х 2 мл 3 х 18 мл + 3 х 2 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C18.1.20	42571	**ЛДГ кинетика**	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом.	1. Буфер, pH 7,5 при 37º С: Na_2HPO_4 – 50 ммоль\л; пируват – 0,6 ммоль\л; 2. Раствор НАДН: НАДН – 0,18 ммоль\л; Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C18.5.20	42572			
C19.1.10	42581	**Магний**	Набор реагентов для определение концентрации магния в биологических жидкостях колориметрическим методом с ксилидиловым синим, без депротеинизации.	1. Монореагент: Good`s буфер, 100 ммоль\л, pH 11,43; Ксилидиловый синий – 150 мкмоль\л. 2. Калибратор – 1,0 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.
C19.1.20	42582			
C20.1.10	42593	**Молочная кислота**	Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом	1. Буфер, pH 7,5 (конечные концентрации в тесте): Pipes – 50 ммоль\л; 4-хлорфенол – 6 ммоль\л. 2. Раствор ферментов (конечные концентрации в тесте): 4-ААП – 0,4 ммоль\л; Лактатоксидаза > 200 МЕ\л; Пероксидаза > 2000 МЕ\л; 3. Калибратор – 4,44 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
C20.5.10	42594			
C30.1.20	42618	**Мочевая кислота UR-PAP**	Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом, без депротеинизации.	1. Фосфатный буфер, 100 ммоль\л, pH 7,8. 3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат – 5 ммоль\л; Детергент – 2 г\л. 2. Раствор ферментов: Уриказа – 300 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л. 4-аминоантипирин – 1 ммоль\л. 3. Калибратор – 595 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C30.5.20	42619			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы центрифугировать и исследовать немедленно. Охлаждение или замораживание образцов недопустимо.	Линейность – от 25 до 810 МЕ\л (Вариант №1) или от 50 до 1200 МЕ\л (Вариант №2). Коэффициент вариации – не более 5 %	18 мл + 2 мл 5 х 18 мл + 5 х 2 мл
1. Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при 2-8º С. 2. Моча. Образец подкислить несколькими каплями концентрированной HCl до pH 3-4 и развести дистиллированной водой в соотношении 1:3. 3. Ликвор. Примесь крови недопустима.	Линейность – от 0,15 до 2,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	10 мл 20 мл
1. Сыворотка, гепариновая или фторид\оксалат плазма крови. Отделить от клеток для предупреждения потерь в течение 15 минут. Избегать применения жгута. Гемолиз недопустим. Образцы хранить на льду и исследовать в день взятия пробы. 2. Моча. Собирать в темную посуду на льду. Исследовать в день взятия пробы. 3. Ликвор. Исследовать немедленново избежание ложно низких результатов.	Линейность – от 0,3 до 16,6 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	9 мл + 1 мл 5 х 9 мл + 5 х 1 мл
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С. 2. Моча суточная. Не охлаждать. Образец перед анализом развести физиологическим раствором в соотношении 1:9. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 35 до 1500 мкмоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	18 мл + 2 мл 5 х 18 мл + 5 х 2 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C21.1.20	42087	**Мочевина UV-ПК**	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях псевдокинетическим UV-методом.	1. Good`s буфер, 100 ммоль/л, pH 8,0; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л. Уреаза ≥ 12000 МЕ\л; Глутаматдегидрогеназа ≥ 1500 МЕ\л. 2. Раствор НАДН (конечные концентрации в тесте) НАДН – 0,18 ммоль\л; 3. Калибратор – 13,3 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C21.5.20	42088			
C21.5.50	42089			
C23.1.20	42645	**Триглицериды**	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме крови энзиматическим колориметрическим методом.	1. Good`s буфер, 50 ммоль/л, pH 7,0; 4-хлорфенол – 5 ммоль\л; $MgSO_4$ – 1 ммоль\л; 4-ААП – 0,5 ммоль\л. 2. Раствор ферментов: Липаза – 1500 МЕ\л; Глицерокиназа – 200 МЕ\л; Глицерофосфатоксидаза – 1000 МЕ\л; Пероксидаза – 250 МЕ\л. 3. Калибратор – 2,29 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
C23.5.20	42646			
C23.5.50	42647			
C09.1.50	42714	**Фосфор неорганический**	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови UV- методом без депротеинизации.	1. Молибденовый реагент (конечные концентрации в тесте): Аммоний молибдат – 1,5 ммоль\л; H_2SO_4 – 340 ммоль\л. 2. Детергент (конечная концентрация в тесте): Полисорбат 20-100 мг\л. 3. Калибратор – 1,615 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте в течение 24 месяцев.
C09.5.50	42715			
C24.1.50	42701	**Хлориды**	Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом без депротеинизации.	1. Железо азотнокислое: $Fe(NO_3)_3$ – 40 ммоль\л. 2. Меркуриотиоцианат: $Hg(SCN)_2$ – 2 ммоль\л. 3. Калибратор – 100 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте в течение 24 месяцев.
C24.5.50	42702			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С. Не использовать в качестве антикоагулянта оксалат. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести бидистиллированной водой в соотношении 1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 0,5 до 33,3 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	18 мл + 2 мл
		5 х 18 мл + 5 х 2 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл
Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма крови после 12 часового голодания. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 7 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность – 0,1- 11,4 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	18 мл + 2 мл
		5 х 18 мл + 5 х 2 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл
Сыворотка крови натощак. Использование липемических и гемолизированных образцов недопустимо. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 5 суток.	Линейность – от 0,2 до 6,46 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	50 мл + 0,5 мл
		5 х 50 мл + 5 х 0,5 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести дистиллированной водой в 2 раза.	Линейность – от 10 до 150 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	45 мл + 5 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл

Кат. №	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
C05.1.50	42666	**Холестерин общий**	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом.	1. Монореагент: Good`s буфер – 75 ммоль\л, pH 6,8; Фенол – 5 ммоль\л; 4-ААП – 0,5 ммоль\л; Холестеролэстераза – 350 МЕ\л; Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л. 2. Калибратор – 5,17 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
C05.5.50	42667			
C05.3.250	42668			
C052.1.100	44477	**Холестерин ЛПВП** **В состав набора входит калибратор!**	Набор реагентов для определения концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым иммунологическим энзиматическим колориметрическим методом без осаждения.	Реагент 1, pH 7,0: Good`s буфер – 75 ммоль\л; ГСДА – 0,3 г\л; Детергенты и стабилизаторы. Реагент 2, pH 7,0: 4-ААП – 0,5 ммоль\л; Холестеролэстераза – 350 МЕ\л; Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л; Детергенты и стабилизаторы; Калибратор –1,29 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
C053.1.100	44478	**Холестерин ЛПНП** **В состав набора входит калибратор!**	Набор реагентов для определения концентрации ЛПНП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым энзиматическим колориметрическим методом без осаждения.	Реагент 1, pH 6,8, 90 мл; Good’s буфер; Холестеролэстераза; Холестеролоксидаза; Каталаза; ГСДА; Детергенты и стабилизаторы. Реагент 2, pH 7,0, 30 мл: Ингибитор каталазы; 4-ААП; Пероксидаза; Детергенты и стабилизаторы; Калибратор (лиофилизат) – 1,0 мл. Реагенты 1 и 2 готовы к использованию и стабильны в течение 12 месяцев при температуре 2-8°С в темноте.
C25.1.20	42728	**Щелочная фосфатаза кинетика**	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови кинетическим методом. ДЭА буфер, pNPP - субстрат DGKC.	1. ДЭА буфер, pH 9,8: Диэтаноламин – 1 моль\л; Магний хлористый – 1 ммоль\л. 2. Субстрат: р-нитрофенилфосфат, 10 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
C25.5.20	42729			
C25.5.50	42730			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка, ЭДТА- или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность – от 0,5 до 25,8 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	50 мл
		5 х 50 мл
		3 х 250 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность – от 0,05 до 3,89 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	90 мл + 30 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны при температуре -20°С в течение 5 суток. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность - 0,02-10,34 ммоль/л; Коэффициент вариации - 5 %.	90 мл + 30 мл
Сыворотка (плазма) крови. Образцы после немедленного охлаждения, стабильны при температуре 2-8º С в течение 48 часов. Замораживание образцов недопустимо.	Линейность – от 20 до 700 ммоль\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	18 мл + 2 мл
		5 х 18 мл + 5 х 5 мл
		5 х 45 мл + 5 х 5 мл

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКТИВЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ

Новые наборы НПФ «АБРИС+»

ВНИМАНИЕ!!! В комплект наборов входят калибраторы!

ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (с калибратором)

Набор реагентов для определения концентрации ЛПВП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым иммунологическим энзиматическим колориметрическим методом без осаждения

Кат.№ С052.1.100 - 100 определений при конечном объёме пробы 1,2 мл. Реагенты готовы к использованию и стабильны в течение 12 месяцев при температуре от +2 до +8˚С в темноте.

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) содержат намного меньше холестерина и намного больше белка и фосфолипидов (примерно 50%). Липопротеиды высокой плотности способны удалять холестерин со стенки сосудов и других тканей и транспортировать его в печень для «утилизации». Поэтому ЛПВП считается «хорошим» холестерином.

ХОЛЕСТЕРИН ЛПНП (с калибратором)

Набор реагентов для определения концентрации ЛПНП-холестерина в сыворотке и плазме крови прямым энзиматическим колориметрическим методом без осаждения

Кат.№ С053.1.100 - 100 определений при конечном объеме пробы 1,2 мл. Реагенты готовы к использованию и стабильны в течение 12 месяцев при температуре от +2 до +8˚С в темноте.

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) содержат до 45% холестерина, 10% триглицеридов и 20% фосфолипидов. Липопротеиды низкой плотности - главное «транспортное средство» для холестерина на его пути от печени к клеткам. Но, к сожалению, ЛПНП и ЛПОНП являются и основным фактором риска в развитии атеросклероза, поскольку холестерин из этих соединений очень легко переходит в стенку сосуда и формирует атеросклеротическую бляшку. Поэтому ЛПНП и ЛПОНП называют «плохим» холестерином, хотя без него организму тоже никак нельзя обойтись.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Показатель		Мужчины	Женщины
HGB	гемоглобин	130-160 г/л	120-140 г/л
RBC	эритроциты	4,3-5,7 x10^9л	3,8-5,1x10^9 л
MCV	средний объем эритроцитов	80-100 фл	
MCH	среднее содержание Hb эритроците	27-33 пг	
MCHC	средняя концентрация Hb в эритроците	33-37 г/дл	
RDW	показатель распределения эритроцитов по объему	10-20 %	
RDW-SD	стандартное отклонение размера эритроцитов от среднего значения	37-46 фл	
RDW-CV	коэффициент вариации отклонения размера эритроцитов от среднего значения	11-16 %	
HCT	гематокрит	43-49 %	36-46 %
PLT	тромбоциты	150-400x10^9 /л	
PCT	тромбокрит	0,15-0,40	
MPV	средний объем тромбоцитов	7,4-10,4 фл	
PDW	относительная ширина распределения тромбоцитов по объему	10-20 %	
P-LCR %	крупные тромбоциты (более 12 фл)	15-35 %	
WBC	количество лейкоцитов	4-10x10^9 л	
% LYM	лимфоциты	15-40 %	
LYM	абсолютное количество	1-4 x 10^9 / л	
% MON	моноциты	3-13%	
MON	абсолютное количество	0,2-1,0x10^9л	
% GRA	гранулоциты	50-70 %	
GRA	абсолютное количество	2,0-7,0 x 10^9 /л	
EO	эозинофилы абсолютный показатель	0-0,5x10^9 /л	
BA	базофилы абсолютный показатель	0-0,2x10^9 /л	
MXD %	смешанная фракция эозинофилов,моноцитов,базофилов	3-13 %	
MXD	абсолютное количество	0,2-1,0x10^9 л	
Neutro %	нейтрофилы	50-70 %	
Neutro	абсолютное число	2,0-7,0x10^9 л	
IMM %	содержание незрелых гранулоцитов	Не предназначены для диагностического использования	
IMM	абсолютное число		
αTL %	содержание атипичных лимфоцитов		
aTL	абсолютное число		
	СОЭ по м-ду Панченкова	до 8 мм/ч	до 12 мм/ч
	СОЭ по м-ду Вестергрена	0-15 мм/ч	0-20 мм/ч
	Цветовой показатель	0,9-1,10	0,9-1,10

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
312.1.50	41992	**АЛТ кинетика, IFCC**	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови энзиматическим кинетическим методом.	1. Буфер, pH 7,5 при 37°С: Трис – 100 ммоль\л; L-аланин - 500 ммоль/л; ЛДГ>1200 МЕ/л. 2. Раствор НАДН - 0,18 ммоль/л.; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
312.1.100	41987			
312.2.400	42009	**АЛТ метод Райтмана-Френкеля**	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля.	1. Буфер – субстратная смесь (БСС), pH 7,4: Na_2HPO_4 – 100 ммоль\л; L-аланин – 100 ммоль\л; α-кетоглутарат – 2 ммоль\л. 2. 2,4-ДНФГ – 1 ммоль\л; 3. Калибратор – пируват натрия – 1 ммоль\л; 4. NaOH (концентрат) – 4 моль\л. Компоненты набора №1,2 и 3 содержат готовые к использованию реагенты, стабильные при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев. Раствор NaOH следует развести бидистиллированной водой, свободной от карбонатов, в соотношении 1:9. Хранить в пластиковой герметичной таре.
312.2.1000	42010			
317.1.50	42043	**Альбумин BCG**	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом на основе реакции с бромкрезоловым зеленым.	1. Монореагент, pH 4,2: Цитрат натрия – 100 ммоль\л; Бромкрезоловый зеленый – 100 мкмоль\л. 2. Калибратор – 60 г\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
317.1.250	42044			
314.1.20	42302	**Альфа-Амилаза кинетика**	Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях кинетическим оптимизированным методом.	1. Буфер, pH 6,0 (конечные концентрации в тесте): MES – 50 ммоль\л; $CaCl_2$ – 2 ммоль\л; NaCl – 100 ммоль\л. 2. Субстрат (конечные концентрации в тесте): G3ClpNPh – 5 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
314.1.50	42312			
314.1.100	42313			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должно быть проведено в день забора образца, так как активность АЛТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 2 до 190 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5%	45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должно быть проведено в день забора образца, так как активность АЛТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 0,1 до 4 ммоль\л в час или от 0,028 – 1,112 мкмоль\л в секунду; Коэффициент вариации – не более 10%	400 опр. (при кон. объеме пробы 3 мл)
		1000 опр. (при кон. объеме пробы 3 мл)
Сыворотка крови. Использование липемических или гемолизированных образцов недопустимо. Образцы стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 15 до 60 г\л. Коэффициент вариации – 5%	монореагент 50 мл
		монореагент 250 мл
1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С не более 30 суток. 2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде. Довести pH образца до слабощелочного значения перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С не более 7 суток.	Линейность – от 16 до 1640 МЕ/л. Коэффициент вариации – 5%	18 мл + 2 мл
		45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
314.3.200	41231	**Альфа-Амилаза метод Каравея**	Набор реагентов для определение активности альфа-амилазы в биологических жидкостях методом Каравея.	1. Буфер фосфатный, 200 ммоль\л, pH 6,9, 105 мл: 2. Субстрат (крахмал по Литнер), 4,5 мл. Йод, 35 ммоль\л, 7 мл. 3. Калий фтористый, 4,3 моль\л, 14 мл. 4. соляная кислота, 1,8 моль\л, 50 мл. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
313.1.50	41936	**АСТ кинетика, IFCC**	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови энзиматическим кинетическим методом.	1. Буфер, pH 7,8 при 37°С; Трис - 80 ммоль/л; L- аспартат - 240 ммоль/л; МДГ > 600 МЕ\л; ЛДГ > 600 МЕ/л. 2. Раствор НАДН: НАДН - 0,18 ммоль/л.; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
313.1.100	41939			
313.2.400	42298	**АСТ метод Райтмана-Френкеля**	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля.	1. Буфер-субстратная смесь (БСС), pH 7,4: Na_2HPO_4 – 100 ммоль\л; L-аспартат натрия – 100 ммоль\л; α-кетоглутарат – 2 ммоль\л. 2. 2,4-ДНФГ – 1 ммоль\л; 3. Калибратор – пируват натрия – 1 ммоль\л; 4. NaOH (концентрат) – 4 моль\л. Компоненты набора №1,2 и 3 содержат готовые к использованию реагенты, стабильные при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев. Раствор NaOH следует развести бидистиллированной водой, свободной от карбонатов, в соотношении 1:9. Хранить в пластиковой герметичной таре.
313.2.1000	42300			
312/ 313.2.400	42978	**АСТ/АЛТ метод Райтмана-Френкеля**	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля.	

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка крови. Хранить при температуре 2-8º С не более 30 суток. 2. Моча. Образцы нестабильны в кислой среде. Довести pH образца до слабощелочного значения перед хранением. Хранить при температуре 2-8º С не более 7 суток.	Линейность реакции сохраняется в течение 10 минут. Коэффициент вариации – не более 10%	200 опр.
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должнобыть проведено в день забора образца, так как активность АСТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 2 до 190 МЕ/л. Коэффициент вариации – не более 5%	45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Исследование должно быть проведено в день забора образца, так как активность АСТ снижается независимо от температуры хранения.	Линейность – от 0,1 до 4 ммоль\л в час или от 0,028-1,112 мкмоль\л в секунду. Коэффициент вариации – не более 10%	400 опр. (при кон. объеме пробы 3 мл)
		1000 опр. (при кон. объеме пробы 3 мл)
		200 + 200 опр.

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
306.3.250	42330	**Белок BPhB**	Набор реагентов для определения общего белка в моче и ликворе колориметрическим методом на основе реакции с бромфеноловым синим.	1. Буфер, pH 3,0: Na_2HPO_4 – 100 ммоль\л; $C_6H_8O_7$ – 17 ммоль\л. 2. Хромоген: Бромфеноловый синий – 20 мкмоль\л. 3. Калибратор: Альбумин бычий сывороточный – 0,25 г\л; NaCl – 150 ммоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 12 месяцев.
306.2.50*	42318	**Белок PGR**	Набор реагентов для определения общего белка в ликворе и моче колориметрическим методом на основе реакции с пирогаллоловым красным.	1. Монореагент, pH 2,5 (конечные концентрации в тесте): Сукцинат натрия – 50 ммоль\л; Молибдат натрия – 1,6 ммоль\л; Пирогаллоловый красный – 0,6 ммоль\л. 2. Калибратор: Альбумин бычий сывороточный – 0,2 г\л; NaCl – 150 ммоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 24 месяцев.
306.2.100*	42321			
306.2.250*	42323			
306.4.2500	43133	**Белок в моче с сульфосалициловой кислотой**	Набор реагентов для количественного и качественного определения содержания общего белка в моче турбидимитрическим методом на основе реакции с сульфосалициловой кислотой.	Реагент 1; Реагент 2 (25-кратный концентрат); Реагент 3 (25-кратный концентрат); Калибратор – 0,25 г\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 24 месяцев.
306.1.1000	42345	**Белок общий**	Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови биуретовым методом.	1. Монореагент (конечные концентрации в тесте): NaOH – 100 ммоль\л; KJ – 15 ммоль\л; $KNaC_4H_4O_6$ – 21 ммоль\л; $CuSO_4$ – 6 ммоль\л. 2. Калибратор: Альбумин бычий сывороточный – 70 г\л; NaCl – 150 ммоль\л. Все компоненты набора готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте, в течение 24 месяцев.
306.1.250К	42388			
306.1.5000	42981			

*** Внимание!**
Для данного метода приобретайте контрольный материал адаптированный для контроля качества химических методов исследования мочи, в список которых входит колориметрический метод на основе реакции с пирогаллоловым красным.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Моча утренняя порция после туалета наружных половых органов. Не применять консервантов. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение года при температуре -20º С. 2. Ликвор. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение 3 суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при температуре -20º С. Исследуемые образцы не должны содержать крови.	Линейность – от 0,125 до 0,5 г/л. Коэффициент вариации – 5%	250 мл
1. Моча утренняя порция. Не применять консервантов. В период сбора образца содержать его на льду. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение года при температуре -20º С. 2. Ликвор. Центрифугировать при 900 g (2000-2500 об\мин., 15 мин при радиусе ротора не менее 16,5 см.) и довести pH до 7,0. Образец стабилен в течение 3 суток при температуре 2-8º С или 6 месяцев при температуре -20º С. Исследуемые образцы не должны содержать крови.	Линейность – от 0,1 до 2,0 г/л. Коэффициент вариации – не более 5%	монореагент 50 мл
		монореагент 100 мл
		монореагент 250 мл
Моча суточная. В период сбора образца содержать его на льду. Центрифугировать при 900g в течение10 минут (или фильтровать) и довести pH до 7,0. Использование мутных образцов, а также образцов со щелочной реакцией приводит к получению недостоверных результатов.	Линейность – от 0,05 до 1,0 г/л. Коэффициент вариации – не более 5%	80 мл + 2500 мл
Сыворотка или плазма крови. Срок хранения исследуемых образцов при температуре 2-8º С не более 3 суток; при температуре -20º С не более 6 месяцев.	Линейность – от 14 до 100 г/л. Коэффициент вариации – не более 5%	монореагент 1000 мл
		концентрат 250 мл
		монореагент 5000 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
326.1.400	42429	**Билирубин**	Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Йендрашека-Грофа.	1. Сульфаниловая кислота – 24 ммоль\л. 2. Нитрит натрия – 72 ммоль\л. 3. Кофеиновый реагент: кофеин – 240 ммоль\л, бензоат натрия – 250 ммоль\л. 4. Физиологический раствор. 5. Калибратор – 85,5 мкмоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С, в течение 12 месяцев.
311.1.20	42458	**ГГТФ кинетика**	Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом.	1. Буфер, pH 8,0: Трис – 100 ммоль\л; Глицилглицин – 150 ммоль\л. 2. Субстрат, pH 7,15: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 6 ммоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С, в течение 12 месяцев.
311.1.50	42459			
311.2.200	42127	**ГГТФ “конечная точка”**	Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови унифицированным методом по “конечной точке”.	1. Буфер, pH 8,25, 80 мл: Трис – 100 ммоль\л; Глицилглицин – 150 ммоль\л. 2. Субстрат: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 6 ммоль\л., 20 мл. 3. Уксусная кислота, 5,6 моль\л, 200 мл. 4. Калибратор – p-нитроанилин, 0,75 ммоль\л, 2 мл. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте, в течение 12 месяцев.
331.1.2500	42764	**Гемоглобин Диахим-Гемциан**	Набор реагентов для определения гемоглобина в крови унифицированным гемоглобинцианидным методом	1. Монореагент (10-ти кратный концентрат): KH_2PO_4 – 10 ммоль\л; $K_3[Fe(CN)_6]$ – 6 ммоль\л; АЦГ – 12 ммоль\л; Детергент. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Хранить в темноте.	Линейность – от 2,0 до 270 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5%	400 опр. (при конечном объеме 2 мл)
Сыворотка крови. Образцы стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.	Линейность – от 6 до 230 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5%	18 мл + 2 мл 45 мл + 5 мл
Сыворотка крови. Образцы стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 30 суток.	Линейность – от 5 до 240 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 7%	200 опр. (при конечном объеме пробы 3,5 мл)
Свежая капиллярная кровь. Антикоагулянт – ЭДТА. Проба с антикоагулянтом стабильна 48 часов при 2-8º С. Непосредственно перед анализом пробу с антикоагулянтом необходимо тщательно перемешать.	Линейность – от 50 до 300 г\л. Коэффициент вариации – не более 2%	Концентрат 250 мл (без калибратора)

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
304.2.100	42470	**Глюкоза UV - HK**	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях гексокиназо-глюкозо-6-фосфатдегидрогеназным энзиматическим референтным методом. “Гексокиназный” метод.	1. Буфер, pH 7,6; Pipes – 100 ммоль\л; АТФ – 4 ммоль\л; $НАД^+$ - 3 ммоль\л. 2. Раствор ферментов: Гексокиназа > 1000 МЕ\л; Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа > 3000 МЕ\л. 3. Калибратор – 5,55 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
304.2.250	42472			
304.3.250	42488	**Глюкоза GOD - PAP**	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови, сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом. Глюкозооксидазный метод по Триндеру.	1. Буфер, pH 7,5: Na_2HPO_4 – 150 ммоль\л; Фенол – 11 ммоль\л; 4-ААП – 0,77 ммоль\л. 2. Раствор ферментов: Глюкозооксидаза – 15 000 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л. 3. Калибратор – 5,55 ммоль\л. 4. Кислота хлорная (концентрат). Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 24 месяцев.
304.3.500	42489			
304.3.1000	42490			
301.1.20	42511	**Железо Nitro-PAPS**	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации.	1. Монореагент, pH 4,3: $C_2H_3O_2Na$ – 50 ммоль\л; Nitro-PAPS – 35 мкмоль\л; CH_5N_3 × HCl – 2,25 моль\л. 2. Калибратор – 30 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев. Нагревание монореагента до температуры свыше 25º С в течение короткого времени (от 3 до 5 суток) приводит к термическому разрушению Nitro-PAPS.
310.1.50	42512			
310.1.100	42513			
310.1.250	42514			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для предупреждения потерь. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3 суток при 2-8º С. 2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов при температуре 18-25º С. 3. Моча. Собирать в темную посуду на льду. Консерванты для суточной мочи – 5 мл ледяной уксусной кислоты или 5 г бензоата или фторида натрия. 4. Ликвор. Исследовать немедленно во избежание ложно низких результатов. Хранить при -20º С.	Линейность – от 1,0 до 38,9 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5%	100 мл + 1 мл
		250 мл + 2,5 мл
1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для предупреждения потерь. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 3 суток при 2-8º С. 2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или иодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов при температуре 18-25º С. 3. Цельная кровь. Консервант – фторид натрия. В качестве антикоагулянта использовать гепарин.	Линейность – от 1,0 до 30 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5%	250 мл + 5 мл
		500 мл + 10 мл
		1000 мл + 20 мл
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при температуре 18-25º С.	<u>Вариант 1:</u> Линейность – 5-179 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5% <u>Вариант 2:</u> Линейность – 1-45 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5%	монореагент 20 мл
		монореагент 50 мл
		монореагент 100 мл
		монореагент 250 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
310.2.50	42509	**Железо Ferene**	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке крови колориметрическим методом без депротеинизации.	1. Буфер, pH 4,3: CH_3COONa – 100 ммоль\л; $CH_5N_3 \times HCl$ – 2,25 моль\л. 2. Редуктант – 50 ммоль\л (сухая навеска). 3. Хромоген – 600 мкмоль\л. 4. Калибратор – $FeCl_3$ - 30 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
310.2.100	42510			
310.2.250	42755			
308.1.50	42558	**Калий**	Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации.	1. Монореагент: Тетрафенилборат натрия – 35 ммоль\л; Натрий едкий – 200 ммоль\л. 2. Калибратор – 5 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев. После вскрытия упаковки монореагент стабилен в течение 1 месяца при температуре 18-25º С.
308.1.100	42559			
307.2.100	42531	**Кальций OCP**	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови унифицированным колориметрическим методом с о-крезолфталеиновым-комплексоном.	1. Буфер, pH 10,7: Моноэтаноламин – 750 ммоль\л. 2. Хромоген: о-крезолфталеин-комплексон – 0,3 ммоль\л; 8-гидроксиквинолин – 10 ммоль\л. 3. Калибратор – 2,5 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
307.2.500	42532			
307.1.100	42546	**Кальций Арсеназо III**	Набор реагентов для определения концентрации кальция в биологических жидкостях колориметрическим методом с Арсеназо III.	1. Монореагент, pH 6,0: Натрий уксуснокислый – 100 ммоль\л; Арсеназо III - 250 мкмоль\л. 2. Калибратор – 2,5 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
307.1.250	42547			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы брать утром. Образцы стабильны в течение рабочего дня при температуре 18-25º С.	Линейность – 5-179 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5%	50 мл
		100 мл
		250 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Хранить не более 8 часов при температуре 2-8º С.	Линейность – от 1 до 10 ммоль\л. Коэффициент вариации – не более 7%	монореагент 50 мл
		монореагент 100 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови натощак. Кровь брать при минимальном пережатии вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА!	Линейность – от 0,2 до 3,75 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	биреагент 50 мл + 50 мл
		биреагент 250 мл + 250 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови натощак. Кровь брать при минимальном пережатии вены, без мышечной нагрузки. Не использовать в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТА! 2. Моча суточная. Собирать в емкость, содержащую 10 мл 6 моль\л HCl, или подкислить после сбора до pH 3-4 для растворения солей кальция. Образец перед анализом развести бидистиллированной водой в соотношении 1:1.	Линейность – от 0,3 до 4,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	монореагент 100 мл
		монореагент 250 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
327.1.100	40292	**Кислая фосфатаза кинетика**	Набор реагентов для определения активности кислой фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом.	1. Цитратный буфер. 2. Тартрат натрия. 3. а-нафтилфосфат. 4. Прочный красный TR. Реагенты стабильны в течение года при температуре 2-8°С.
327.2.250	42804	**Кислая фосфатаза “конечная точка”**	Набор реагентов для определения активности кислой фосфатазы в сыворотке крови унифицированным методом по “конечной точке”.	1. Цитратный буфер, 90 ммоль\л, pH 4,8. 2. Тартрат натрия, 20 ммоль\л. 3. р-Нитрофенилфосфат, 25 ммоль\л. 4. Калибратор – р-нитрофенол, 0,75 ммоль\л. 5. NaOH, 1 моль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
316.2.100	42413	**Креатинин ЯФФЕ КТ**	Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях на основе реакции Яффе с депротеинизацией.	1. Пикриновая кислота – 35 ммоль\л. 2. Натрий едкий – 750 ммоль\л. 3. Трихлоруксусная кислота (ТХУ) – 1,22 моль\л. 4. Калибратор – 177 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев. Калибратор после вскрытия флакона следует хранить при температуре 2-8º С.
316.2.500	42414			
316.1.100	42389	**Креатинин ЯФФЕ ПК**	Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депротеинизации.	1. Пикриновая кислота – 9 ммоль\л. 2. Натрий едкий – 190 ммоль\л. 3. Калибратор – 177 мкмоль\л. Реагенты стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев. Калибратор перед использованием следует развести в 100 раз дистиллированной водой. Подготовленный к работе (разведенный) калибратор стабилен в течение недели при 2-8º С.
316.1.500	42390			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 7 суток при стабилизации $NaHSO_4$ (5 мг/мл).	Линейность – до 75 МЕ/л, Коэффициент вариации – 5%.	100 мл
Сыворотка крови.	Линейность – до 48 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 10%	250 опр.
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Липемическая и гемолизированная сыворотка или плазма крови для анализа не пригодна. Возможно хранение образцов при температуре 2-8º С в течение суток. 2. Моча суточная, разведенная непосредственно перед анализом дистиллированной водой в соотношении 1: 99. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 4 суток.	Линейность – в сыворотке (плазме) крови от 5 до 440 мкмоль\л, в моче – от 0,25 до 44,2 ммоль\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	100 мл 500 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Липемическая и гемолизированная сыворотка или плазма крови для анализа не пригодна. Возможно хранение образцов при температуре 2-8º С в течение суток. 2. Моча суточная, разведенная непосредственно перед анализом дистиллированной водой в соотношении 1: 49. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 4 суток.	Линейность – в сыворотке\плазме от 5 до 885 мкмоль\л, в моче – от 0,25 до 44,2 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	50 мл + 50 мл 250 мл + 250 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
328.1.50	42748	**Креатинкиназа NAC UV-кинетика**	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови энзиматическим кинетическим методом.	1. Буфер, pH 6,7: Имидазол – 100 ммоль\л; Mg ацетат – 10 ммоль\л; Глюкоза – 20 ммоль\л; ЭДТА – 2 ммоль\л; N-ацетилцистеин – 20 ммоль\л; НАДФ – 1,2 ммоль\л; Г-6-ФДГ ≥ 1,5 МЕ\л; Гексокиназа ≥ 2,5 МЕ\л. 2. Субстрат – Креатинфосфат – 30 ммоль\л; АДФ – 2 ммоль\л; АМФ – 5 ммоль\л; Диаденозинпентафосфат – 10 мкмоль\л; Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
328.1.100	42749			
318.1.50	42570	**ЛДГ UV-кинетика**	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом.	1. Буфер, pH 7,5 при 37º С: Na_2HPO_4 – 50 ммоль\л; пируват – 0,6 ммоль\л. 2. Раствор НАДН: НАДН – 0,18 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в течение 12 месяцев.
319.1.50	42579	**Магний**	Набор реагентов для определение концентрации магния в биологических жидкостях колориметрическим методом с ксилидиловым синим,без депротеинизации.	1. Монореагент, pH 11,43: Трис - 100 ммоль\л; Ксилидиловый синий – 150 мкмоль\л. 2. Калибратор – 0,82 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.
319.1.100	42580			
320.1.50	42592	**Молочная кислота**	Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом	1. Буфер, pH 7,5 (конечные концентрации в тесте): Pipes – 50 ммоль\л; 4-хлорфенол – 6 ммоль\л. 2. Раствор ферментов (конечные концентрации в тесте): 4-ААП – 0,4 ммоль\л; Лактатоксидаза > 200 МЕ\л; Пероксидаза > 2000 МЕ\л. 3. Калибратор – 3,34 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25º С или 2 суток при 2-8º С.	Линейность – от 5 до 1040 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы центрифугировать и исследовать немедленно. Охлаждение или замораживание образцов недопустимо.	Линейность – от 50 до 1200 МЕ\л Коэффициент вариации – не более 5 %	45 мл + 5 мл
1. Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при 2-8º С. 2. Моча. Образец подкислить несколькими каплями концентрированной HCl до pH 3-4 и развести дистиллированной водой в соотношении 1:3. 3. Ликвор. Примесь крови недопустима.	Линейность – от 0,15 до 2,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	монореагент 50 мл
		монореагент 100 мл
1. Сыворотка, гепаринизированная, оксалатная или обработанная фторидом плазма крови. Отделить от клеток для предупреждения потерь в течение 15 минут. Избегать применения жгута. Гемолиз недопустим. Образцы хранить на льду и исследовать в день взятия пробы. 2. Моча. Собирать в темную посуду на льду. Исследовать в день взятия пробы. 3. Ликвор. Исследовать немедленновo избежание ложно низких результатов.	Линейность – от 0,3 до 16,6 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	45 мл + 5 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
330.1.100	42617	**Мочевая кислота UR-PAP**	Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом, без депротеинизации.	1. Фосфатный буфер, 100 ммоль\л, pH 7,8: 3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат – 5 ммоль\л; Детергент – 2 г\л. 2. Раствор ферментов: Уриказа – 300 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л; 4-аминоантипирин – 1 ммоль\л. 3. Калибратор – 595 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8° С в течение 12 месяцев.
330.2.130	42606	**Мочевая кислота**	Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в биологических жидкостях колориметрический фенантролиновым метод, без депротеинизации.	1. Глициновый буфер, 100 ммоль\л, pH 5,8. 2. Фенантролиновый реагент: $FeCl_3$ – 25 ммоль\л; Орто-фенантролин – 50 ммоль\л. 3. Калибратор – 595 мкмоль\л. Реагенты готовы к использованию. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8° С в течение 12 месяцев.
321.1.375	42099	**Мочевина ДАМО**	Набор реагентов для определения содержания мочевины в биологичеких жидкостях колориметрическим методом на основе реакции с диацетилмонооксимом.	1. Диацетимонооксим – 5 ммоль\л. 2. Железо солянокислое – 100 мкмоль\л; HSO – 100 ммоль\л. 3. Тиосемикарбазид – 1 ммоль\л. 4. Калибратор – 13,3 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25° С в течение 12 месяцев.
321.2.50	42082	**Мочевина UV-ПК**	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях псевдокинетическим UV-методом.	1. Буфер, pH 8,0: Трис - 100 ммоль/л; α-кетоглутарат – 15 ммоль\л; Уреаза ≥ 12000 МЕ\л; Глутаматдегидрогеназа ≥ 1500 МЕ\л. 2.Раствор НАДН (конечные концентрации в тесте) НАДН – 0,18 ммоль\л. 3.Калибратор – 13,3 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 2-8° С в течение 12 месяцев.
321.2.100	42083			
321.2.250	42086			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С. 2. Моча суточная. Не охлаждать. Образец перед анализом развести физиологическим раствором в соотношении 1:9. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 35 до 1500 мкмоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	90 мл + 10 мл
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 5 суток. 2. Моча суточная. Не охлаждать. Перед анализом образец развести физиологическим раствором в соотношении 1:9. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 5 суток.	Линейность – от 30 до 1200 мкмоль\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	130 определений
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 3 суток. Не использовать в качестве антикоагулянта оксалат. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести бидистиллированной водой в соотношении 1:24 - 1:99. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 4 суток.	Линейность – от 0,5 до 20,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	375 опр
1. Сыворотка или плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 3 суток при температуре 2-8º С. Не использовать в качестве антикоагулянта оксалат. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести бидистиллированной водой в соотношении 1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 0,5 до 33,3 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл
		225 мл + 25 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
321.3.100	42103	**Мочевина Уреаза-ФГ**	Набор реагентов для определения мочевины в биологических жидкостях колориметрическим уреазным/фенол-гипохлоритным методом.	1. Раствор уреазы – 30 000 МЕ\л. 2. Фенол-нитропруссидный реагент: Фенол – 100 ммоль\л; Нитропруссид натрия – 0,2 ммоль\л. 3. Гипохлорит натрия – 90 ммоль\л. 4. Калибратор – 13,3 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 12 месяцев.
321.3.250	42110			
322.1.50	42627	**Натрий**	Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови колориметрическим методом.	1. Осаждающий реагент – уранилацетат магния – 30 ммоль\л. 2. Хромоген – тиогликолят аммония – 600 ммоль\л. 3. Калибратор – натрий хлористый – 150 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев в темноте.
322.1.100	42628			
310.3.500	42766	**ОЖСС**	Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом с использованием основного карбоната магния. Дополнительно требуется набор для определения концентрации железа.	1.Раствор железа хлорного, 180 мкмоль\л, 100 мл. 2.Карбонат магния основной, 10 г. Реагенты готовы к использованию. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.
333.1.50	44065	**Пировиноград-ная кислота**	Набор реагентов для определения концентрации пировиноградной кислоты в крови энзиматическим UV-методом.	1. Депротеинизатор - 50 мл. 2. Good’s буфер - 50 мл. 3. НАДН - 10 мл. 4. ЛДГ - 1,0 мл. 5. Калибратор, 50 мкмоль/л - 20 мл. 6. Калибратор, 250 мкмоль/л - 20 мл. 7. Калибратор «ноль» (холостая проба) – 20 мл. Все компоненты набора готовы к использованию и стабильны в не вскрытой упаковке производителя в течение 18 месяцев при температуре 2-8°С. После вскрытия флаконов компоненты набора стабильны в течение 60 суток при хранении в плотно закрытых флаконах при температуре 2-8°С.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
1. Сыворотка или плазма крови. Хранить при температуре 2-8º С не более трех суток. Не использовать в качестве антикоагулянта оксалат. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести бидистиллированной водой в соотношении 1:99. Образцы стабильны в течение 4 суток при температуре 2-8º С.	Линейность – от 0,5 до 25,0 ммоль\л. Коэффициент вариации – 8 %	100 опр. 250 опр.
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим. Центрифугировать кровь как можно скорее.	Линейность – от 30 до 300 ммоль\л. Коэффициент вариации – не более 7 %	50 мл 100 мл
Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 4 суток при температуре 18-25º С.	Референнтные пределы: 44,8-76,1 мкмоль\л	500 опр.
Венозная кровь, натощак.	Линейность – от 10 до 650 мкмоль/л. Коэффициент вариации – 5 %	50 опр.

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
332.1.330	42765	**Тимоловая проба**	Набор реагентов для проведения тимоловой пробы, позволяющей оценить изменение содержания белковых и липопротеиновых фракций сыворотки крови.	1. Концентрированный раствор тимола в трис-малеатном буфере – 6,66 ммоль\л. 2. Серная кислота – 2 моль\л. 3. Хлорид бария – 48 ммоль\л. Все компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.
323.1.50	42642	**Триглицериды**	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом	1. Буфер, pH 7,0: PIPES - 50 ммоль/л, 4-хлорфенол – 5 ммоль\л; $MgSO_4$ – 1 ммоль\л; 4-ААП – 0,5 ммоль\л. 2. Раствор ферментов: Липаза – 1500 МЕ\л; Глицерокиназа – 200 МЕ\л; Глицерофосфатоксидаза – 1000 МЕ\л; Пероксидаза – 250 МЕ\л. 3. Калибратор – 2,29 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
323.1.100	42643			
323.1.250	42644			
309.1.250	42713	**Фосфор неорганический**	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови UV- методом без депротеинизации.	1. Молибденовый реагент (конечные концентрации в тесте): Аммоний молибдат – 1,5 ммоль\л; H_2SO_4 – 340 ммоль\л. 2. Детергент (конечная концентрация в тесте): Полисорбат 20-100 мг\л. 3. Калибратор – 1,615 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте в течение 24 месяцев.
324.1.50	42699	**Хлориды**	Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в биологических жидкостях колориметрическим методом без депротеинизации.	1. Железо азотнокислое: $Fe(NO_3)_3$ – 40 ммоль\л. 2. Меркуриотиоцианат: $Hg(SCN)_2$ – 2 ммоль\л. 3. Калибратор – 100 ммоль\л. Компоненты набора стабильны при температуре хранения 18-25º С в темноте в течение 24 месяцев.
324.1.250	42700			

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка крови. Гемолиз недопустим.	Линейность – до 20 ед. S-H Коэффициент вариации – не более 8 %	330 опр
Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма крови после 12 часового голодания. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 7 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность – 0,1- 11,4 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	45 мл + 5 мл
		90 мл + 10 мл
		225 мл + 25 мл
Сыворотка крови натощак. Использование липемических и гемолизированных образцов недопустимо. Образцы стабильны при температуре 2-8º С в течение 5 суток.	Линейность – от 0,2 до 6,46 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	250 мл
1. Сыворотка или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. 2. Моча суточная. Перед анализом образец развести дистиллированной водой в 2 раза.	Линейность – от 10 до 150 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	45 мл + 5 мл
		225 мл + 25 мл

Кат.№	Артикул	Наименование товара	Описание набора	Состав набора и условия хранения
305.1.100	42661	**Холестерин общий**	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом.	1. Монореагент, pH 6,8: PIPES – 75 ммоль\л; Фенол – 5 ммоль\л; 4-ААП – 0,5 ммоль\л; Холестеролэстераза – 350 МЕ\л; Холестеролоксидаза – 350 МЕ\л; Пероксидаза – 1000 МЕ\л. 2. Калибратор – 5,17 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 2-8º С в темноте в течение 12 месяцев.
305.1.250	42662			
305.1.500	42663			
305.2.50	42665	**Холестерин ЛПВП**	Набор реагентов для определения концентрации холестерина липротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека. Осаждение фосфовольфраматом в присутствии ионов магния. Для проведения анализа необходим набор для определения общего холестерина.	1. Осаждающий реагент Фосфорновольфрамовая кислота – 0,55 ммоль\л; $MgCl_2$ – 25 ммоль\л. 2. Калибратор –1,29 ммоль\л. Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре хранения 18-25º С в течение 24 месяцев.
305.2.250	42664			
305.3.100	43868	**Холестерин ЛПНП**	Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови человека. Для проведения анализа необходим набор для определения концентрации общего холестерина, кат.№ 305.1.100 или 305.1.250 или 305.1.500.	1. Осаждающий реагент, pH 5,04. Гепарин – 100 Ед/л; 2. Калибратор. Холестерин – 5,17 ммоль/л. Реагенты готовы к использованию и стабилны при температуре 18-25°
305.3.250	43875			
325.1.250	42726	**Щелочная фосфатаза кинетика**	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови кинетическим методом.	1. ДЭА буфер, pH 9,8: Диэтаноламин – 1 моль\л; Магний хлористый – 1 ммоль\л. 2.Субстрат: р-нитрофенилфосфат, 10 ммоль\л.
325.2.500	42727	**Щелочная фосфатаза КТ**	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови унифицированным методом по “конечной точке”.	1. Глициновый буфер, 50 ммоль\л, pH 10,4 – 80 мл: 2. Субстрат: р-нитрофенилфосфат, 6 ммоль\л, 20 мл. 3. NaOH 200 ммоль\л – 100 мл. 4. Калибратор – р-нитрофенол, 50 мкмоль\л, 10 мл. Компоненты набора №№1,2 и 4 содержат готовые к использованию реагенты, стабильные в течение года при температуре 18-25º С. Раствор NaOH следует развести бидистиллированной водой, свободной от карбонатов, в соотношении 1:9.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Исследуемый материал	Аналитические характеристики набора	Фасовка
Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С или до трех месяцев при температуре -20º С. Избегать повторного замораживания и оттаивания образца.	Линейность – от 0,5 до 25,8 ммоль\л. Коэффициент вариации – 5 %	100 мл
		250 мл
		500 мл
Сыворотка, ЭДТА - или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны в течение 5 суток при температуре 2-8º С.		50 мл
		250 мл
Сыворотка крови.		100 мл
		250 мл
Сыворотка (плазма) крови. Образцы после немедленного охлаждения, стабильны в течение 48 часов при температуре 2-8º С Замораживание образцов недопустимо.	Линейность – от 20 до 700 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 5 %	225 мл + 25 мл
Сыворотка (плазма) крови. Образцы после немедленного охлаждения, стабильны в течение 48 часов при температуре 2-8º С Замораживание образцов недопустимо.	Линейность – от 6 до 120 МЕ\л. Коэффициент вариации – не более 7 %	500 опр.

Кат. №	Наименование	Описание набора	Фасовка	Ед.
303.1.250Л	**АСО латекс**	Латекс - агглютинация. Латекс-реагент.	5 мл	уп.
303.1.100	**АСО Экспресс-латекс**	Набор для качественного и полуколичественного экспресс определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.	100 опр.	уп.
303.1.250			250 опр.	уп.
301.1.250Л	**РФ латекс**	Латекс - агглютинация. Латекс-реагент.	5 мл	уп.
302.1.100	**РФ Экспресс-латекс**	Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.	100 опр.	уп.
302.1.250			250 опр.	уп.
301.1.250Л	**СРБ латекс**	Латекс-агглютинация. Латекс-реагент.	5 мл	уп.
301.1.100	**СРБ Экспресс-латекс**	Набор для качественного и полуколичественного экспресс-определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.	100 опр.	уп.
301.1.250			250 мл	уп.

Кат. №	Наименование	Описание набора	Фасовка	Ед.
405	**Альбумин**	Калибратор для определения альбумина по реакции с бромкрезоловым зеленым. Концентрация 60 г/л.	2 мл	шт.
406	**Белок в ликворе и моче**	Калибратор для определения белка по реакции с бромфеноловым синим и пирогаллоловым красным. Концентрация 0,25 г/л.	20 мл	шт.
407	**Белок в ликворе и моче**	Набор калибраторов для определения белка по реакциям с бромфеноловым синим и пирогаллововым красным. Концентрация 0,125 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л, 1,0 г/л.	4 х 5 мл	шт.
408	**Белок в сыворотке (плазме) крови**	Калибратор для определения общего белка по биуретовой реакции. Концентрация 70 г/л.	5 мл	шт.
409	**Белок в сыворотке (плазме) крови**	Набор калибраторов для опр.общего белка по биуретовой реакции. Концентрация 14 г/л, 35 г/л, 70 г/л и 100 г/л.	4 х 5 мл	шт.
410	**Билирубин**	Калибратор для определения билирубина. Метод Йендрашека. Концентрация 85,5 мкмоль/л.	5 х 2 мл	шт.
411	**Глюкоза**	Калибратор для определения глюкозы. Концентрация 5,55 ммоль/л . Объем 5 мл.	5 мл	шт.
412	**Глюкоза**	Набор калибраторов для определения глюкозы. Концентрация 1,0 ммоль/л, 5,55 ммоль/л, 10 ммоль/л и 30 ммоль/л.	4 х 5 мл	шт.
413	**Железо**	Калибратор для определения железа. Концентрация 30 мкмоль/л.	5 мл	шт.
414	**Железо**	Набор калибраторов для определения железа. Концентрация 5 мкмоль/л, 30 мкмоль/л, 90 мкмоль/л и 180 мкмоль/л	4 х 5 мл	шт.
415	**Кальций**	Калибратор для определения кальция. Концентрация 2,5 ммоль/л.	5 мл	шт.
416	**Креатинин**	Калибратор для определения креатинина при использовании набора “КРЕАТИНИН КТ” кат.№ 316.2.100, 316.2.500. Концентрация 177 мкмоль/л.	20 мл	шт.
417	**Креатинин**	Калибратор для определения креатинина при использовании набора “КРЕАТИНИН ПК” Кат.№ 316.1.100, 316.1.500. Концентрация 177 мкмоль/л.	10 мл	шт.
418	**Мочевина**	Калибратор для определения мочевины. Концентрация 13,3 ммоль/л.	20 мл	шт.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Кат. №	Наименование	Описание набора	Фасовка	Ед.
419	**Мочевина**	Набор калибраторов для определения мочевины. Концентрация 1 ммоль/л, 13,3 ммоль/л, 20 ммоль/л.	3 х 20 мл	шт.
404	**Пируват натрия**	Калибратор для определения АЛТ и АСТ методом Райтмана-Френкеля. Концентрация 1 ммоль/л.	20 мл	шт.
420	**Триглицериды**	Набор калибраторов для определения триглицеридов энзиматическим колориметрическим методом. Концентрация 0,1 ммоль/л, 2,29 ммоль/л, 11,4 ммоль/л.	3 х 5 мл	шт.
422	**Хлориды**	Калибратор для определения хлоридов. Концентрация 100 ммоль/л.	5 мл	уп.
423	**Холестерин**	Набор калибраторов для опр.холестерина энзиматическим колориметрическим методом. Не пригоден для метода Илька! Концентрация 0,5 ммоль/л, 5.17 ммоль/л и 10.24 ммоль/л	3 х 5 мл	шт.

Кат. №	Наименование товара	Описание набора	Фасовка	Ед.
426	**Универсальный промывающий раствор**	Отлично подходит для всех полуавтоматических биохим. анализаторов, а также кювет и треков. Удаляет белковые отложения, смывает биологические красители, очищает системы отводящих и подводящих трубок проточной кюветы от высаливания и обызвествления, обладает дезинфицирующими свойствами. Концентрат. Разведение 1:50.	концентрат 1 литр	шт.
425	**Промывающий кислотный р-р (Сапфир 400)**	Концентрат. Срок годности рабочего раствора 10 дней. Разведение 1:100.	концентрат 500 мл	шт.
424	**Промывающий щелочной р-р (Сапфир 400)**	Концентрат. Срок годности рабочего раствора 10 дней. Разведение 1:50.	концентрат 500 мл	шт.

403	**Вода деионизованная** (по запросу может быть расфасована в любых объемах)		1 литр	фл.
			5 литров	фл.
402	**Вода дистиллированная**		1 литр	фл.
401	**Хлорная кислота 3% для депротеинизации**		250 мл	фл.
427	**Диахим-Буфер Э**	Системный раствор для прибора Эксан Г	6 фл. на 6 литров	уп.
Набор калибраторов глюкозы для анализатора Эксан Г. Концентрация 10 ммоль/л			4х5 мл	уп.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Объем р-ра\ число опр.	Ед.
163	**Диахим-ГемиСтейн - МГ**	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду).	1 л (3 000 опр.)	л.
164	**Диахим-ГемиСтейн - Л**	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий типа Лейшмана).	1 л (3 000 опр.)	л.
165	**Диахим-ГемиСтейн-Р “Профессионал”**	Краситель форменных элементов крови (периферическая кровь, костный мозг, др. биопрепараты) (р-р азур-эозина по Романовскому).	1 л (6 000 опр.)	л.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Объем р-ра\ число опр.	Ед.
27947	**Диахим-ГемиСтейн-Р “Классик”**	Краситель форменных элементов крови (периферическая кровь) (р-р азур-эозина по Романовскому).	1л (8 000 опр.)	л.
31628	**Диахим-ГемиСтейн-Р “Классик” + 5фл. Буфер -Г (на 3л р-ра)**	Набор для гематологических исследований.	1 л + 5 фл. буфера	л.
30494	**Диахим-ГемиКомб**	Набор для окраски форменных элементов крови и костного мозга (окраска по Паппенгейму).	2 х 100 мл (600 опр.)	уп.
35738	**Диахим-ГемаТ**	Набор для окраски мазков крови на приборе Hema Tek (краситель, буфер, промывочный раствор).	250 мл	уп.
42136	**Диахим-Фиксатор для автоматических устройств окраски**		1 л	л.
38837	**Смесь для очистки и обезжиривания**	Аналог смеси Никифорова, не взрывоопасна. Минимум 5000 стекол.	1 л	л.
38839	**Реагент для подсчета тромбоцитов**	Ручная методика, в камере Горяева.	500 мл	фл.
38840	**Реагент для подсчета эритроцитов**	Ручная методика, в камере Горяева.	500 мл	фл.
38841	**Реагент для подсчета лейкоцитов**	Ручная методика, в камере Горяева.	500 мл	фл.
38842	**Раствор фенолфталеина 1%**	Р-р для проверки остаточных моющих средств на предметных стеклах и медицинском инструментарии.	100 мл	фл.
43158	**Диахим-Буфер-Г pH 6,8-7,2 100-кратный концентрат**	Более стабилен, экономичен, удобен! 50 мл разводим до 5 л. Можно приготовить из концентрата любое необходимое количество буфера, отмерив соответствующий объем концентрата, если нужно меньшее количество буфера!	50 мл	фл.
	Диахим-Буфер-Г	Буферная смесь для гематологии, pH-6.8-7.2.	на 3 л	фл.
42764	**Диахим-Гемциан концентрат (без калибратора)**	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови унифицированным колориметрическим методом.2.5 л рабочего раствора. Метод 1- на анализ идет 2 мл рабочего раствора (1250опр), метод 2- на анализ идет 5 мл раб. р-ра (500 опр).	250 мл.	уп.
41398	**Набор реагентов для окраски по Нохту**	Состав: Водные растворы азур II и эозина.	3000 опр.	уп.
41397	**Реактив для окраски телец Гейнца**	Готов к употреблению.	4000 опр	фл.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Объем р-ра\ число опр.	Ед.
10202	**Диахим-ГемиСтейн - РТЦ**	Раствор для окраски ретикулоцитов (суправитальный пробирочный метод).	50 мл (от 500 опр.)	фл.
36651	**Диахим-ГемиСтейн - РТЦ 50**	На 50 определений, в пробирках. Раствор для окраски ретикулоцитов.	12,5 мл	уп.
4	**Диахим-Гемихром**	Набор реактивов для определения гемоглобина в крови гемихромным методом. Без калибратора.	600 опр.	уп.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Объем р-ра\ число опр.	Ед.
29757	**Диахим-ЦитоСтейн-МПО (с бензидином)**	Набор реагентов для определения миелопероксидазы в лейкоцитах с бензидином.	12 опр.	уп.
29758	**Диахим-ЦитоСтейн-МПО (с о-толидином)**	Набор реагентов для определения миелопероксидазы в лейкоцитах с орто-толидином.	12 опр.	уп.
29826	**Диахим-ЦитоСтейн-СЧ**	Набор реагентов для цитохимического определения фосфолипидов в лейкоцитах.	6 опр.	уп.
29824	**Диахим-ЦитоСтейн-ПАС**	Набор реагентов для цитохимического определения гликогена в лейкоцитах.	6 опр.	уп.
29918	**Диахим-ЦитоСтейн-НЭ**	Набор реагентов для цитохимического определения неспецифической эстеразы в лейкоцитах.	10 опр.	уп.
29996	**Диахим-ЦитоСтейн-ХЭ**	Набор реагентов для цитохимического определения хлорацетатэстеразы в лейкоцитах.	10 опр.	уп.
30282	**Диахим-ЦитоСтейн-КФ**	Набор реагентов для цитохимического определения кислой фосфатазы в лейкоцитах.	12 опр.	уп.
29826	**Диахим-ЦитоСтейн-ЩФ**	Набор реагентов для цитохимического определения щелочной фосфатазы в лейкоцитах.	6 опр.	уп.
29333	**Диахим-ЦитоСтейн-С**	Набор реагентов для цитохимического определения сидеробластов и сидероцитов в клетках эритроидного ряда.	100 мл	уп.
35796	**Диахим-Дифф-Квик**	Набор для быстрого дифференцированного окрашивания сперматозоидов.	100 мл	уп.
37507	**Диахим-УриСтейн**	Набор для суправитальной окраски осадка мочи. Модифицированный краситель Штейнгеймера-Малбина.	100 мл	уп.
36528	**Диахим-ЦитоСтейн Ф 1**	Фиксатор для цитохимии- МПО, ПАС, НЭ, КФ.	500 мл	фл.
36527	**Диахим-ЦитоСтейн Ф 2**	Фиксатор для цитохимии - ЩФ.	500 мл	фл.
36531	**Диахим-ЦитоСтейн Ф 3**	Фиксатор для цитохимии- СЧ.	500 мл	фл.
36612	**Диахим-ГемиСтейн-Баз**	Краситель базофилов и тучных клеток.	50 мл	фл.
28713	**Диахим-ЦитоСтейн-ГК**	Гематоксилин Каракци. Краситель для цитологии и гематологии.	250 мл	фл.
28712	**Диахим-ЦитоСтейн-ГМ**	Гематоксилин Майера. Краситель для цитологии и гематологии.	250 мл	фл.
32017	**Диахим-ЦитоСтейн-ГЭ**	Гематоксилин Эрлиха. Краситель для цитологии и гематологии.	250 мл	фл.
34309	**Диахим-ЦитоСтейн-ПАП**	Набор реагентов для окраски цитологических препаратов по Папаниколау.	100 мл	уп.
29759	**Диахим-ЦитоСтейн-РШ**	Реактив Шиффа. Краситель для цитологии и гематологии.	250 мл	фл.
30424	**Диахим-ЦитоСтейн-П**	Пararозанилин. Краситель для цитологии и гематологии.	250 мл	фл.
38260	**Раствор эозина водный**	1%-ный раствор для докрашивания цитоплазмы после окраски гематоксилином.	250 мл	фл.
41623	**Раствор эозина водный**	5%-ный раствор для докрашивания цитоплазмы после окраски гематоксилином.	250 мл	фл.
38261	**Раствор эозина спиртовый**	1%-ный раствор для докрашивания цитоплазмы после окраски гематоксилином.	250 мл	фл.
38262	**Реактив Самсона**	Краситель для исследования ликвора.	100 мл	фл.
41615	**Раствор нигрозина**	10%-ный раствор. Для окраски эякулята и дифференциации живых и мертвых сперматозоидов.	250 мл	шт.
40820	**Диахим-ЦитоСтейн-Амилоид**	Набор для цитологической окраски на амилоид.	2х50 опр.	уп.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Объем р-ра\ число опр.	Ед.
40819	**Диахим-ЦитоСтейн-Альциановый**	Набор для цитологической окраски на слизь с альциановым синим (основной гистохимический метод окраски).	2х50 опр.	уп.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Фасовка	Ед.
10118	**Диахим-СК**	Набор для обнаружения скрытой крови в биологических материалах и контроля качества предстерилизационной обработки медицинских изделий. Метод основан на способности о-толидина образовывать соединение сине-зеленого цвета при контакте с атомарным кислородом, выделяющимся при взаимодействии перекиси водорода с кровью.	5х10	уп.
НОВИНКА! 44712	**Диахим - Азопирам (для контроля предстерилизионной очистки медизделий)**		4×2000 опр.	уп.
38842	**Раствор фенолфталеина (1%)**	Раствор для проверки на остаточные количества моющих средств на посуде.	100 мл	фл.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Фасовка	Ед.
41864	**Диахим-Набор для окраски по Граму (с сафранином)**	Состав набора:карболовый раствор генцианвиолета, раствор Люголя, раствор сафранина.	200 опр.	шт.
43283	**Диахим-Набор для окраски по Граму (с фуксином Циля)**	Состав набора: карболовый раствор генцианвиолета, раствор Люголя, раствор фуксин Циля.	200 опр.	шт.
42941	**Диахим-набор для окраски по Граму (с нейтральным красным)**	Для окраски урогенитальных трихомонад. В состав набора входит-карболовый раствор генцианвиолета, раствор Люголя, раствор нейтрального красного (1%).	200 опр.	шт.
43282	**Диахим-Набор для окраски по Циль-Нильсену**	Состав набора: фуксин Циля, солянокислый спирт, метиленовый синий	200 опр.	шт.
41855	**Диахим-Реактив Като (100 мл)**	Реактив для обнаружения гельминтов методом толстого мазка. Для проведения определения необходим гидрофильный целлофан.	до 5000 мазков	шт.
41842	**Диахим-Метиленовый синий по Леффлеру**	Метиленовый синий по Леффлеру.Краситель для окраски и исследования бактерий.	100 мл	шт.
41850	**Диахим-Раствор Люголя**	Раствор для использования в наборе для окраски по Граму.	100 мл	шт.
41840	**Диахим-Насыщенный раствор метиленового синего**	Насыщенный расвор метиленового синего. Краситель для окраски.	100 мл	шт.
41849	**Диахим-Фуксин Циля (100 мл)**	Краситель для окраски и исследования микроорганизмов. Может использоваться самостоятельно или в качестве реагента в наборе для окраски по Циль-Нильсену и Граму.	200 (при расх. на одно иссл. 0,5 мл)	шт.
42285	**Диахим-Набор для исследования фекалий на гельминты (Като)**	Набор для микроскопического исс-ния фекалий на гельминты (метод Като).Состав: реактив Като и пластинки из гидрофильного целлофана.	500 опред.	уп.
НОВИНКА! 44609	**Диахим - Набор для исследования на гельминты (по Рабиновичу)**		50 опред	шт.
	Нейтральный формалиновый буфер (10%)		1 л.	уп.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

	Артикул	Наименование товара	Описание товара	Фасовка	Ед.
НОВИНКА!	43381	**Диахим-Набор для клинического анализа кала**	Набор для исследования кала на скрытую кровь, стеркобилин, билирубин, жиры и микроскопического исследования.	100 опред. -скытая кровь, 50 опред. - стеркобилин, 200 опред. -билирубин, 2000 опред. -микроскопич. исследования	уп.
	43382	**Диахим-Набор для клинического анализа мокроты**	Набор для исследования мокроты на гемосидерин, кислотоустойчивые и кислотонеустойчивые микроорганизмы, клетки злокачественных опухолей.	100 опред. - гемосидерин, 200 опред. -кислотоустойч. микроорганизмов, 300 опред. -злокачественных клеток	уп.
	43905	**Диахим-Набор для клинического анализа мочи**	Набор для анализа pH, глюкозы, кетонов, билирубина, уробилиноидов, качественного и количественного определения содержания белка в моче.	1000 проб - опред. pH, белка, глюкозы, кетонов, уробилиноидов; 400 проб - качественное определение билирубина, 330 проб - количественное определение белка	уп.
	43906	**Диахим-Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости**	Набор для анализа цитоза, качественного и колическвенного определения общего белка и качественного определения глобулинов.	анализ 200 проб спинномозговой жидкости	уп.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Ед.
41274	**Держатель для контейнера 0,8 л д/сбора острого инструментария**		шт.
41270	**Контейнер д/сбора острого инструментария 0,8 л**	Со специально оборудованной крышкой для обеспечения безопасной работы персонала (**см. рекламу на стр. 49**).	шт.
41720	**Контейнер для сбора острого инструментария 0,8 л с этикеткой**		шт.
43305	**Контейнер-Дезинфектор**	Контейнер объемом 15 литров предназначен для сбора и дезинфекции (химическим методом) отходов ЛПУ. Состоит из емкости (15л.) желтого цвета с краном для слива, решетки, внутренней и наружной крышки (**см. рекламу на стр. 50**).	шт.

39654	**0,33 х 0,3 м, белый, кл. А**	Класс А – неопасные отходы ЛПУ: отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы – пищевые отходы всех отделений, кроме инфекционных, неинфицирован. бумага, строительный мусор и т.д.	шт.
39070	**0,5 х 0,6 м, белый, кл. А**		шт.
39071	**0,6 х 0,8м, белый, кл. А**		шт.
39072	**0,6 х 1м, белый, кл. А**		шт.
39399	**0,33 х 0,3 м, желтый, кл. Б**	Класс Б – опасные (рискованные отходы) ЛПУ: потенциально инфицированные отходы – материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, в т.ч. кровью, выделениями пациентов, патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, отходы инфекционных отделений, отходы микробиологических лабораторий, работающих с культурами 3-4 классов патогенности, биологические отходы вивариев.	шт.
39400	**0,33 х 0,6 м, желтый, кл. Б**		шт.
39073	**0,5 х 0,6 м, желтый, кл. Б**		шт.
39074	**0,6 х 0,8 м, желтый, кл. Б**		шт.
40106	**0,7 х 0,8 м, желтый, кл. Б**		шт.
39075	**0,6 х 1 м, желтый, кл. Б**		шт.
39087	**0,7 х 1,1 м, желтый, кл. Б**		шт.
41751	**0,8 х 1,1 м, желтый, кл. Б**		шт.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Ед.
39076	**0,5 х 0,6 м, красный, кл. В**	Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ: все материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями, отходы микробиологических лабораторий, работающих с культурами 1-2 классов патогенности, отходы фтизиатрических, микологических больниц, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.	шт.
39077	**0,6 х 0,8 м, красный, кл. В**		шт.
39078	**0,6 х 1 м, красный, кл. В**		шт.
39079	**0,5 х 0,6 м, черный, кл. Г**	Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным: просроченные лекарственные средства, цитостатики и другие химиопрепараты, рентгеновская пленка, ртутьсодержащие предметы и оборудование.	шт.
39080	**0,6 х 0,8 м, черный, кл. Г**		шт.
39081	**0,6 х 1 м, черный, кл. Г**		шт.
37830	**Стяжка**	Замок-стяжка для герметизации пакетов с отходами	шт.
	Этикетка	Бирка для маркировки отходов в подразделениях ЛПУ. Графы: Код подразделения ЛПУ; Название ЛПУ; Дата; Отв. за сбор отходов.	шт.
38646	**класс: А**		шт.
37829	**класс: Б**		шт.
38859	**класс: В**		шт.
37787	**класс: Г**		шт.

Артикул	Наименование товара	Описание товара	Ед.
43431	**0,33 х 0,3 м, белый, кл. А**	Класс А – неопасные отходы ЛПУ: отходы, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы – пищевые отходы всех отделений, кроме инфекционных, неинфицирован. бумага, строительный мусор и т.д.	шт.
43434	**0,5 х 0,6 м, белый, кл. А**		шт.
43435	**0,6 х 0,8м, белый, кл. А**		шт.
43436	**0,6 х 1м, белый, кл. А**		шт.
43494	**0,33 х 0,3 м, желтый, кл. Б**	Класс Б – опасные (рискованные отходы) ЛПУ: потенциально инфицированные отходы – материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, в т.ч. кровью, выделениями пациентов, патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, отходы инфекционных отделений, отходы микробиологических лабораторий, работающих с культурами 3-4 классов патогенности, биологические отходы вивариев.	шт.
43495	**0,33 х 0,6 м, желтый, кл. Б**		шт.
43496	**0,5 х 0,6 м, желтый, кл. Б**		шт.
43497	**0,6 х 0,8 м, желтый, кл. Б**		шт.
43499	**0,7 х 0,8 м, желтый, кл. Б**		шт.
43498	**0,6 х 1 м, желтый, кл. Б**		шт.
	0,7 х 1,1 м, желтый, кл. Б		шт.
	0,8 х 1,1 м, желтый, кл. Б		шт.
	0,5 х 0,6 м, красный, кл. В	Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ: все материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями, отходы микробиологических лабораторий, работающих с культурами 1-2 классов патогенности, отходы фтизиатрических, микологических больниц, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.	шт.
	0,6 х 0,8 м, красный, кл. В		шт.
	0,6 х 1 м, красный, кл. В		шт.
43501	**0,5 х 0,6 м, черный, кл. Г**	Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным: просроченные лекарственные средства, цитостатики и другие химиопрепараты, рентгеновская пленка, ртутьсодержащие предметы и оборудование.	шт.
43502	**0,6 х 0,8 м, черный, кл. Г**		шт.
43503	**0,6 х 1 м, черный, кл. Г**		шт.
37830	**Стяжка**	Замок-стяжка для герметизации пакетов с отходами	шт.
	Этикетка	Бирка для маркировки отходов в подразделениях ЛПУ. Графы: Код подразделения ЛПУ; Название ЛПУ; Дата; Отв. за сбор отходов.	шт.
38646	**класс: А**		шт.
37829	**класс: Б**		шт.
38859	**класс: В**		шт.
37787	**класс: Г**		шт.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Пакеты разных объёмов для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов

РАЗМЕРЫ	ПЛОТНОСТЬ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО	ЦВЕТ ПАКЕТА
330 х 300 500 х 600 800 х 600 1000 х 600 и другие	20 мкм, >20 мкм под заказ	этикетки и стяжки для герматизации пакетов	белый, жёлтый, красный, чёрный в зависимости от класса отходов

Одноразовая ёмкость-контейнер для сбора, дизинфекции, транспортировки и уничтожения колющих и режущих медицинских отходов классов Б и В

Ёмкость-контейнер одноразовый производится объёмом 0,8 л, имеет форму усечённого конуса, выполнен из непрокалываемого пластика, устойчивого к действию дезинфектантов.

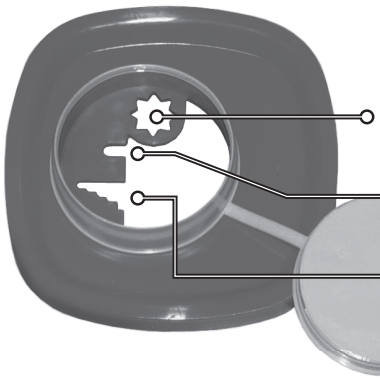

Крышка контейнера оснащена тремя специальными выемками для бесконтактного съёма игл:

МНОГОУГОЛЬНАЯ ВЫЕМКА «ЗВЁЗДОЧКА» (для снятия игл с инсулиновых шприцев)

U-ОБРАЗНАЯ ВЫЕМКА (для снятия игл системы Луер)

СТУПЕНЧАТАЯ ВЫЕМКА (для сброса игл, в том числе для скручивания/сброса игл вакумных систем)

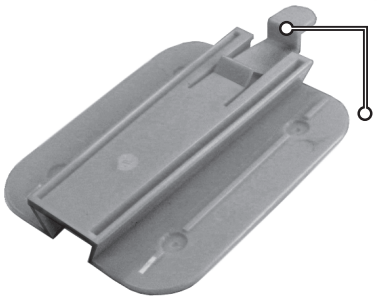

Конструкция контейнера позволяет жёстко закреплять его на рабочей по ерхности с помощью СПЕЦИАЛЬНОГО ФИКСАТОРА, который предупреждает случайное опрокидывание и контаминацию содержимым контейнера рабочей поверхности стола, инструментария, оборудования, персонала и пациентов. Таким образом, вся конструкция и оснащение контейнера позволяет сделать работу медицинского персонала безопасной.

АНАЛОГИЧНОГО УСТРОЙСТВА НА МЕДИЦИНСКОМ РЫНКЕ НЕТ!

КОНТЕЙНЕР ДЕЗИНФЕКТОР

ОБЪЁМ 15 ЛИТРОВ

КОНСТРУКЦИЯ КОНТЕЙНЕРА ОТИМИЗИРУЕТ ПРОЦЕССЫ СБОРА, ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТХОДОВ И УДАЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЗА СЧЕТ НАРУЖНОЙ ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКИ, ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ-ПОГРУЗИТЕЛЯ, ПЕРФОРИРОВАННОГО ДНА-ВСТАВКИ, КРАНА ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО ДЕЗРАСТВОРА.

КОНТЕЙНЕР ВЫПОЛНЕН ИЗ ЭМ-ПЛАСТМАССЫ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ И ОБЛАДАЮЩЕЙ БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СБОРА И ДЕЗИНФЕКЦИИ (ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ) ОТХОДОВ ЛПУ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.АЮ46.В03000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Жёлтый, предварительно перфорированный полиэтиленовый пакет поставить на решётку в контейнер.
2. Материалы, предназначенные для дезинфекции сложить в пакет.
3. Налить в контейнер дезинфицирующий раствор, пакет сверху накрыть внутренней крышкой. Надеть наружную крышку и выдержать время дезинфекции согласно инструкции.
4. После окончания дезинфекции дезинфицирующий раствор слить через кран.
5. Открыть наружную крышку и, надавливая на внутреннюю крышку, постараться выдавить дезинфицирующий раствор из пакета. Вынуть внутреннюю крышку и пакет с материалами, подвергшимися дезинфекции, для последующей утилизации.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440

Артикул	Наименование товара	Ед.
39774	**Журнал учета генеральных уборок (48 страниц, формат А5, вертикальное расположение)** Графы: №, планируемая дата проведения, наименование и концентрация используемого дезсредства, фактическая дата проведения, подпись исполнителя	шт.
39773	**Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки (48 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)** Графы: дата, № лампы, условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной), режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный), время (вкл/выкл), длительность (для повторно-кратковременного интервал между сеансами облучения), остаток часов, ФИО (подпись)	шт.
40344	**Журнал учета количества проведенных лабораторных исследований в отделениях (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)** Предназначен для отчетных записей по дням месяца. Графы: по горизонтали числа от первого до тридцать первого, по вертикали указывается отделение или раздел исследований- гематологические , биохимические и пр.	шт.
40341	**Рабочий журнал регистрации исследований кала на энтеральные паразитозы (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)** Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст, результат—яйцаглист, энтеробиоз (достаточно места для стандартной печати)	шт.
40345	**Журнал учета мероприятий по обслуживанию медицинского оборудования (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)** Первая страница: Перечень медицинского оборудования, обслуживаемого по договору в 20.... году. Графы: №пп., наименование аппарата, тип, марка, завод-изготовитель, № аппарата, год выпуска, примечание. Остальные страницы: перечень работ, произведенных при техническом обслуживании, и замечания медицинского персонала о работе аппаратов. Графы: Дата, перечень произведенных работ и замечания медицинского персонала о работе аппаратов, замененные узлы, детали и расходные материалы, подпись специалиста, выполнившего работы, подпись медицинского работника.	шт.
40339	**Рабочий журнал регистрации исследований мочи (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)** Графы: №, дата, ФИО, адрес пациента, возраст, цветовой показатель, относ. плотность, pH, белок, глюкоза, кетон. тела, билирубин, уробилиноиды, желч. кистоты, микроскопия: пл. эпителий, лейкоциты, эритроциты, цилиндры, неорганиз. осадки (соли), бактерии + дополнительная графа.	шт.
40343	**Рабочий журнал регистрации биохимических исследований (80 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)** Графы: №, ФИО, адрес, возраст, результат: общий белок, альбумин, глюкоза, мочевина, креатинин, холестерин общий, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, амилаза, ЛДГ, КФК, ГГТП, мочевая кислота, калий, натрий, кальций общий, хлориды, железо, ОЖСС, магний, фосфор, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, коэффициент атерогенности, липаза.+ дополнительная графа с возможностью добавить еще 2-3 показателя.	шт.
40340	**Рабочий журнал регистрации исследований кала (копрограмма) (64 страницы, формат А4, горизонтальное расположение)** Графы: №/№, № отделения, № истории болезни, ФИО, адрес пациента, возраст, результат—слизь, кровь, остатки неперваренной пищи, химич. исследования: реакция на крытую кровь, мышечные волокна, жир нейтр., жирные кислоты, мыла, растит. клетчатка перевар., микроскопические исследования: крахмал, иодофильн. флора, кристаллы, слизь, эпителий, лейкоциты, эритроциты + дополнительная графа.	шт.

Артикул	Наименование товара	Ед.
40342	**Рабочий журнал регистрации гематологических исследований (80 страниц, формат А4, вертикальное расположение)** Графы: №, ФИО, адрес, возраст, Hb, эрит., Ht, цв. п., Ret, тром., L, лейкоцитарная формула (миел., метам., п/я, с/я, эоз, Б, лимфоц., пл/кл, мон.) , СОЭ + дополнительная графа на 2-3 показателя.	шт.
40884	**Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств в стационаре/поликлинике/отделении (80 страниц, формат А4, горизонтальное расположение)** **Раздел 1: Расчет потребности в дезинфицирующих средствах.** Графы: №п/п, наименование подразделения, кол-во объектов, площадь объекта, вид обработки (т, г), кратность обработки в месяц, дезинфицирующее средство (наименование, рабочая конц.), расход рабочего р-ра на 1 кв.м, кол-во рабочего р-ра для однократной обработки объекта, потребность в дезинфицирующем средстве (на одну обработку, на один месяц, на один год) **Раздел 2: Сведения о поступлении дезинфицирующих средств.** Графы: № п/п, дата получения, наименование дезинфицирующего средства, номер счета, кол-во закупленного препарата, срок годности, до, ФИО ответственного за выдачу препарата, подпись ответственного за выдачу препарата. **Раздел 3: Сведения о расходовании дезинфицирующих средств в подразделении (в стационаре).** Графы: получено (наименование дезинфицирующего средства, количество), израсходовано (за период с... по ....., количество), остаток, ФИО и подпись лица, ответственного за проведение дезинфекционных работ.	шт.

Мы готовы предоставить любую консультационную и практическую помощь по продукции собственного производства: (812) 727-7049 (812) 727-2440